



Health
i systems

GENERADOR ELECTROLÍTICO

ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON PATENTE MUNDIAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE USO

LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL Y RESPETE EL LÍMITE DIARIO DE PRODUCCIÓN

1 Recomendamos leer el manual antes de la utilización del generador. Su uso, limpieza y conservación son primordiales para su durabilidad. La capacidad máxima de producción del generador es de 1 litro de CDS al día. Sugerimos no exceder este límite.

REALICE CORRECTAMENTE LAS DILUCIONES


2 Para un funcionamiento óptimo del generador, la realización de la dilución es crucial. Recuerde que el resultado de esta variará dependiendo del tipo de clorito que use: polvo o líquido. La dilución no puede ser mayor del 10%, de otro modo el generador se detendrá. En el manual se encuentra especificado cómo hacer estas diluciones según el material de inicio.

EXISTE PERMEABILIDAD ENTRE CÁMARAS

3 Debido a la porosidad de la membrana, ambas cámaras se encuentran conectadas, esto es necesario para su correcto funcionamiento. Como consecuencia de ello, es totalmente normal que se produzca una transferencia de líquidos de un compartimento a otro. Recomendamos llenar primero el compartimento de solución y seguidamente, el de agua.

USO CORRECTO DE LOS COMPLEMENTOS ADICIONALES

4 Los conductos están fabricados con silicona alimentaria, adecuados para este tipo de mecanismo. Aplique la vaselina alimentaria alrededor de los conectores, 1 y 2 en la imagen, antes de poner en funcionamiento el generador. De esta manera, evitará que se peguen o que se produzca cualquier tipo de rotura. Una vez finalizada la producción de CDS, coloque los tapones siempre al guardar el generador.

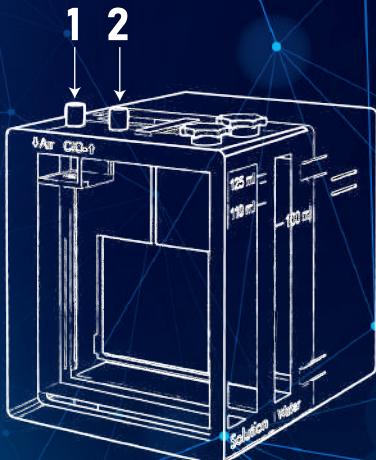




Health®
i systems

ELECTROLYtic
GENERATOR

LATEST TECHNOLOGY WITH WORLDWIDE PATENT

IMPORTANT USAGE INFORMATION

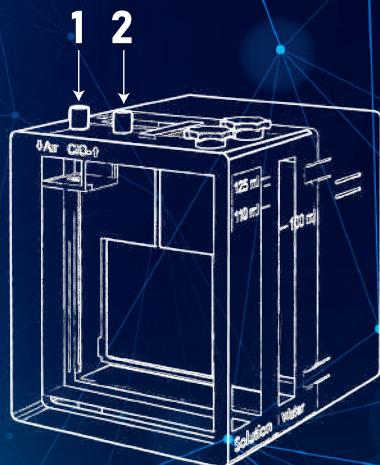

1

READ THE MANUAL CAREFULLY AND RESPECT THE DAILY PRODUCTION LIMIT

We recommend to read the manual before using the generator. Its use, cleaning and maintenance are essential for its durability. The maximum production capacity of the generator is 1 litre of CDS per day. We advise not to exceed this limit.

2

MAKE THE DILUTIONS CORRECTLY

For optimum performance of the generator, dilution is crucial. Remember that the dilution result will vary depending on the type of chlorite you use: powder or liquid. **The dilution must not exceed 10%**, otherwise the generator will stop. The manual specifies how to make these dilutions according to the starting equipment.

3

THERE IS PERMEABILITY BETWEEN COMPARTMENTS

Due to the porosity of the membrane, both compartments are connected, which is necessary for proper functioning. As a result, it is quite normal for liquids to be transferred from one compartment to the other. We recommend filling the solution compartment first and then the water compartment.

4

CORRECT USE OF THE ADDITIONAL SUPPLEMENTS

The conduits are made of food grade silicone, prepared for this type of mechanism. Apply the food vaseline around the connectors, 1 and 2 in the picture, before starting the generator. This will prevent sticking or any kind of breakage. After the CDS production is finished, always put the plugs back in place when storing the generator.





Health®
i systems

ELEKTROLYTISCHER
GENERATOR

NEUESTE TECHNOLOGIE MIT WELTWEITEM PATENT

WICHTIGE VERWENDUNG INFORMATIONEN

LESEN SIE DAS HANDBUCH SORGFÄLTIG
DURCH UND BEACHTEN SIE DIE
TÄGLICHE PRODUKTIONSGRENZE.

Wir empfehlen Ihnen, das Handbuch zu lesen, bevor Sie den Generator benutzen. Seine Verwendung, Reinigung und Wartung sind für seine Langlebigkeit unerlässlich. Die maximale Produktionskapazität des Generators beträgt 1 Liter CDS pro Tag. Wir empfehlern, diesen Grenzwert nicht zu überschreiten.

DIE VERDÜNNUNGEN RICHTIG HERSTELLEN


Für eine optimale Leistung des Generators ist die Verdünnung entscheidend. Denken Sie daran, dass das Ergebnis der Verdünnung von der Art des Chlorits abhängt, das Sie verwenden: Pulver oder Flüssigkeit. Die Verdünnung darf 10 % nicht überschreiten, da der Generator sonst stehen bleibt. Wie Sie diese Verdünnungen je nach Ausgangsmaterial vornehmen, ist im Handbuch angegeben.

ES BESTEHT EINE DURCHLÄSSIGKEIT ZWISCHEN DEN KAMMERN

Aufgrund der Porosität der Membran sind beide Kammern miteinander verbunden, was für das ordnungsgemäße Funktionieren notwendig ist. Daher ist es ganz normal, dass Flüssigkeiten von einer Kammer in die andere übergehen. Wir empfehlen, zuerst das Lösungsfach und dann das Wasserfach zu füllen.

KORREKTE VERWENDUNG ZUSÄTZLICHER ERGÄNZUNGEN

Die Leitungen bestehen aus lebensmittelechtem Silikon, das für diese Art von Mechanismus geeignet ist. Tragen Sie vor der Inbetriebnahme des Generators die Lebensmittelvaseline um die Anschlüsse 1 und 2 auf. Dadurch wird ein Verkleben oder eine Beschädigung verhindert. Nach Beendigung der CDS-Produktion müssen die Stecker bei der Lagerung des Generators immer wieder aufgesteckt werden.

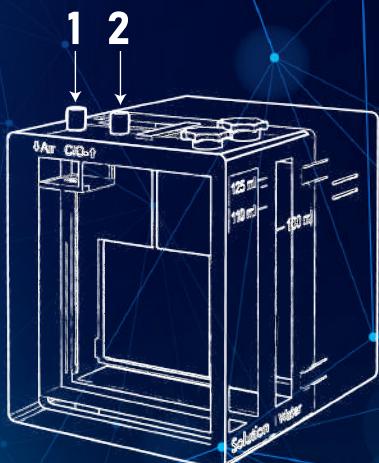




Health
i systems

GÉNÉRATEUR
ÉLECTROLYTIQUE

DERNIÈRE TECHNOLOGIE AVEC BREVET MONDIAL

INFORMATIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

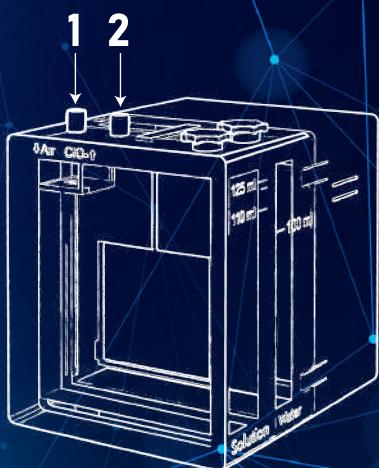

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL ET RESPECTER LA LIMITÉ DE PRODUCTION JOURNALIÈRE

Il est recommandé de lire le manuel avant d'utiliser le générateur. Son utilisation, son nettoyage et son entretien sont essentiels pour sa durabilité.

La capacité de production maximale du générateur est de 1 litre de CDS par jour. Il est conseillé de ne pas dépasser cette limite.

EFFECTUER CORRECTEMENT LES DILUTIONS

Pour une performance optimale du générateur, la dilution est cruciale. N'oubliez pas que le résultat de la dilution varie en fonction du type de chlорite que vous utilisez : poudre ou liquide. La dilution ne doit pas dépasser 10%, sinon le générateur s'arrête. La manière d'effectuer ces dilutions en fonction du produit de départ est précisée dans le manuel.

IL Y A PERMÉABILITÉ ENTRE LES CHAMBRES

En raison de la porosité de la membrane, les deux compartiments sont reliés entre eux, ce qui est nécessaire à leur bon fonctionnement. Il est donc normal que des liquides soient transférés d'un compartiment à l'autre. Nous recommandons de remplir d'abord le compartiment à solution, puis le compartiment à eau.

L'UTILISATION CORRECTE DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Les conduits sont en silicium alimentaire, adapté à ce type de mécanisme. Appliquez la vaseline alimentaire autour des connecteurs, 1 et 2 sur l'image, avant de démarrer le générateur. Cela évitera que les connecteurs ne collent ou ne se cassent. Une fois la production de CDS terminée, remettez toujours les bouchons en place lorsque vous rangez le générateur.






Health
i systems

GENERATORE
ELETTROLITICO

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA CON BREVETTO MONDIALE

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'USO

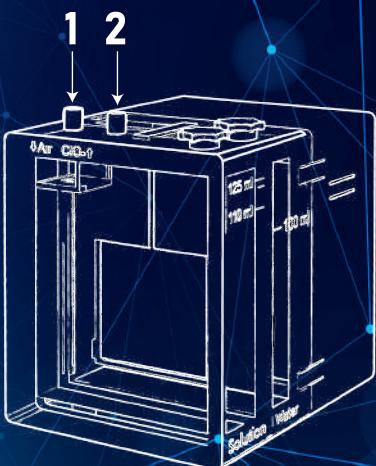

1

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE E RISPETTARE IL LIMITE DI PRODUZIONE GIORNALIERO.

Si consiglia di leggere il manuale prima di utilizzare il generatore. L'uso, la pulizia e la manutenzione sono essenziali per la sua durata. La capacità massima di produzione del generatore è di 1 litro di CDS al giorno. Si consiglia di non superare questo limite.

2

ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE DILUIZIONI

Per ottenere prestazioni ottimali del generatore, la diluizione è fondamentale. Ricordare che il risultato della diluizione varia a seconda del tipo di clorito utilizzato: polvere o liquido. La diluizione non deve superare il 10%, altrimenti il generatore si arresta. Le modalità di diluizione in base al materiale di partenza sono specificate nel manuale.

3

C'È PERMEABILITÀ TRA LE CAMERE

A causa della porosità della membrana, entrambe le camere sono collegate, il che è necessario per il corretto funzionamento. Di conseguenza, è normale che i liquidi vengano trasferiti da uno scomparto all'altro. Si consiglia di riempire prima lo scomparto della soluzione e poi quello dell'acqua.

4

USO CORRETTO DI INTEGRATORI AGGIUNTIVI

Le guaine sono in silicone alimentare, adatto a questo tipo di meccanismo. Applicare la vaselina alimentare intorno ai connettori, 1 e 2 nella figura, prima di avviare il generatore. In questo modo si evitano incollamenti o rotture di qualsiasi tipo. Al termine della produzione di CDS, rimettere sempre i connettori al loro posto quando si ripone il generatore.

